

# Betriebsanleitung für pH/Redox-Sensoren der Reihe SE554



## WARNUNG – Gefahr bei Nichtbeachtung

Das Warnsymbol auf dem Typschild bedeutet:

**Lesen Sie diese Betriebsanleitung, beachten Sie die Technischen Daten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.**

## 1 Sicherheitshinweise

### 1.1 Alle Einsatzbereiche

Je nach Einsatzort sind Gefährdungen durch Druck, Temperatur, aggressive Medien oder explosive Atmosphären möglich. Daher dürfen die Installation, der Betrieb und die Wartung des Sensors nur durch vom Anlagenbetreiber autorisiertes und geschultes Personal durchgeführt werden.

### 1.2 Ex-Bereiche

Die am Errichtungsort geltenden Bestimmungen und Normen für die Errichtung von elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind zu beachten. Zur Orientierung siehe IEC 60079-14, EU-Richtlinien 2014/34/EU und 1999/92/EG (ATEX), NFPA 70 (NEC), ANSI/ISA-RP12.06.01. Die elektrischen und thermischen Kenngrößen der Sensoren müssen eingehalten werden.

### 1.3 Ex-Bereiche – Sensoren mit Memosens-Steckkopf

Memosens-Ex-Sensoren sind durch einen orangefarbenen Ring gekennzeichnet. Der Sensor in Verbindung mit dem Messkabel Typ CA/MS-\*\*\*X\*\* oder Typ CA/MS-\*\*\*X\*\*-L oder ein in Hardware und Funktion identisches und beschleunigtes Messkabel darf an ein geeignetes Messgerät, wie in den Zertifikaten BVS 15 ATEX E141 X und IECEx BVS 15.0114X beschrieben, angeschlossen werden.

### 1.4 Ex-Bereiche – Sensoren mit VP-Steckkopf

Die Sensoren dürfen nur mit einem zugelassenen Gerät an erdfreien, eigensicheren Stromkreisen betrieben werden.

## 2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Sensor dient der kontinuierlichen pH- und optional der Redox-Messung (Typ AMSN) in flüssigen Medien. Der SE 554 ist ein wartungsarmer und druckbeständiger Sensor und verfügt über einen Temperaturfühler zur automatischen Temperaturkompensation. Der Sensor ist für den Einsatz in industriellen Prozessen konzipiert:

- stark verschmutzte Medien
- sulfidhaltige Medien
- Emulsionen und Suspensionen
- basische Medien
- proteinhaltige Medien
- Prozesse mit großen Druckschwankungen
- saure Medien
- Lösungsmittelhaltige Medien

Der Sensor ist nicht geeignet zur Sterilisation/Autoklavierung und für Messungen in chlor- und bromhaltigen Medien.

## 3 Installation und Inbetriebnahme

- Prüfen Sie den Sensor beim Auspacken auf eventuelle mechanische Defekte. Melden Sie Schäden Ihrem Knick Service-Team.
- Entfernen Sie die Wässerungsskappe und spülen Sie den Sensor kurz mit reinem Wasser. Nach dem Abspülen soll der Sensor nur abgetupft werden. Ein Abreiben des pH-sensitiven Glases kann die Ansprechzeit durch elektrostatische Aufladung stark erhöhen.
- Entfernen Sie gegebenenfalls Luftblasen im Raum hinter dem pH-sensitiven Glas durch leichte Schleuderbewegungen in senkrechter Ebene.
- Setzen Sie den Sensor in die Armatur ein, wie in der Anleitung der Armatur beschrieben.
- Verbinden Sie Sensor und Kabel miteinander.

## 4 Betrieb

### 4.1 Kalibrierung des Sensors

Für den Sensor SE554 wird eine pH-2-Punkt-Kalibrierung empfohlen. Zuerst die Wässerungsskappe entfernen. Der Sensor wird dann der Reihe nach in zwei verschiedene Pufferlösungen mit bekannten pH-Werten (z. B. CaliMat pH 7,00 und 4,00) eingetaucht und wird auf diese Pufferwerte kalibriert. Die Redox-Kalibrierung wird als 1-Punkt-Kalibrierung (Delta-Wert) mit einer Redox-Kalibrier-Lösung durchgeführt. Beachten Sie dazu die Anleitung des pH-Messumformers.

### 4.2 Temperaturfühler

Der integrierte Temperaturfühler ist hauptsächlich für die automatische Kompensation des pH-Signals und nicht für eine genaue und sichere Temperaturanzeige oder Steuerung der Prozesstemperatur vorgesehen.

## 5 Wartung und Reinigung

Nach jedem Arbeitszyklus sind Sensorspitze und Diaphragma sorgfältig mit reinem Wasser abzuspülen. Das Antrocknen von Rückständen des Messmediums auf diesen Teilen ist zu vermeiden!

Wenn der Sensor nicht in Gebrauch ist, wird er mit der Sensorspitze und dem Diaphragma in einen Behälter mit Elektrolyt (3 mol/l KCl) eingetaucht gelagert. Wird ein Sensor versehentlich einige Tage trocken gelagert, muss er vor Gebrauch mehrere Stunden in Elektrolyt gewässert werden.

## 6 Technische Daten

### Typschlüssel

Der Aufdruck auf jedem Sensor bzw. auf dem Verpackungsschild enthält folgende Informationen:

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| SE554X/ 1 - AMSN | <b>Typenbezeichnung</b>     |
|                  | <b>Steckkopf</b>            |
|                  | MS: Memosens®               |
|                  | VP: VarioPin                |
|                  | <b>Pt-Elektrode (Redox)</b> |
|                  | A: mit                      |
|                  | N: ohne                     |
|                  | <b>Länge</b>                |
|                  | 1: 120 mm                   |
|                  | 2: 225 mm                   |
|                  | 3: 325 mm                   |
|                  | 4: 425 mm                   |
|                  | <b>Ex - Zulassung</b>       |
|                  | X: ja                       |

### weitere Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| Messbereich pH/Redox | 0 ... 14 / ±1500 mV  |
| Temperatur           | 0 ... 130 °C   |
| Druck relativ        | 0 ... 10 bar   |
| Diaphragma           | 2 x Loch   |
| Elektrolyt           | Festpolymer  |
| Referenzsystem       | Ag/AgCl  |
| Sensormaterial pH    | Alpha-Glas<br>mittlere Impedanz,<br>Universalglas,<br>fluoridbeständig |
| Sensormaterial Redox | Platin   |
| Schaftmaterial       | Glas   |
| Montage              | PG 13,5  |
| Temperaturfühler     | Steckkopf MS: NTC 30 kΩ<br>Steckkopf VP: Pt1000                        |


## 7 Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung sind anzuwenden.

# Knick >

## Manual

SE554X/\*-AMSN  
SE554X/\*-NMSN  
SE554X/\*-NVPN

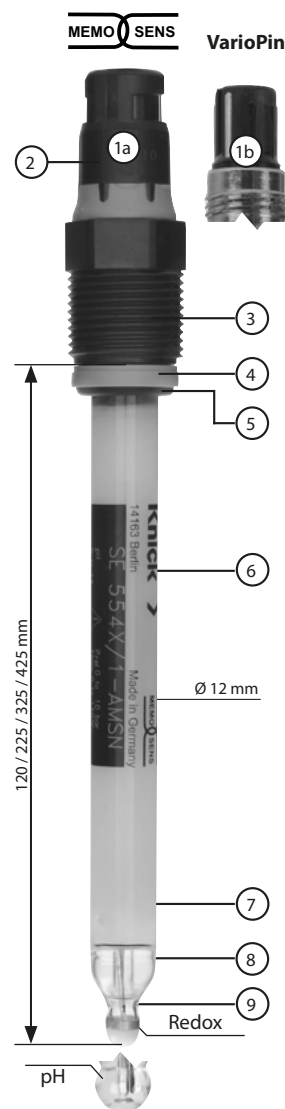

- 1 Steckköpfe:  
a - Memosens (MS)  
b - VarioPin (VP)
- 2 SW19, Aufdruck Seriennummer
- 3 Gewinde PG 13,5
- 4 PVDF-Druckring
- 5 O-Ring EPDM-FDA (11,5 x 2,6 mm)
- 6 Typschild
- 7 Diaphragma
- 8 pH-Glas
- 9 Platin (nur Redox-Sensoren)

### Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22  
14163 Berlin  
Germany  
Phone: +49 30 80191-0  
Fax: +49 30 80191-200  
Email: info@knick.de  
Internet: www.knick-international.com



100584

TA-SE554X-KNXX03 20220809


# Ex-Bereiche: Elektrische und thermische Kenngrößen

## Für Sensoren mit VP-Steckkopf

### Bescheinigungsnummer:

PTB 14 ATEX 2004

### Kennzeichnung:

 II 1/2 G Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb

### Elektrische Kenngrößen:

- Alle Stromkreise einschließlich Schirmleiter und Erde sind aus sicherheitstechnischer Sicht als galvanisch miteinander verbunden anzusehen.
- Metallische Prozessanschlusssteile müssen in den örtlichen Potentialausgleich einbezogen werden.
- Die wirksame innere Induktivität  $L_i$  und Kapazität  $C_i$  sind vernachlässigbar klein.

| Temperaturklasse | Maximale Eingangsspannung $U_i$ | Maximaler Eingangsstrom $I_i$ | Maximale Eingangsleistung $P_i$ |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| T6               | 12 V                            | 30 mA                         | 50 mW                           |
| T4               | 15 V                            | 80 mA                         | 110 mW                          |
| T3               | 18 V                            | 170 mA                        | 200 mW                          |

### Thermische Kenngrößen:

Eine Überschreitung der genormten atmosphärischen Bedingungen im Rahmen der Herstellerangaben, z.B. im Hinblick auf Umgebungstemperatur und -druck, gefährdet nicht die Beständigkeit der Betriebsmittel.

Die im Hinblick auf die Temperaturklasse maximal zu berücksichtigende Erwärmung gründet sich einheitlich auf die verfügbare Leistung der extern angeschlossenen Stromkreise und beträgt 427 K/W in Luft. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40 °C.

| Temperaturklasse | Maximale Eingangsleistung $P_i$ | Maximal zulässige Prozesstemperatur |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| T6               | 50 mW                           | 55 °C                               |
| T4               | 110 mW                          | 80 °C                               |
| T3               | 200 mW<br>110 mW                | 100 °C<br>135 °C                    |

### Besondere Bedingung

ohne

## Für Sensoren mit Memosens-Steckkopf

### Bescheinigungsnummer:

BVS 16 ATEX E 037 X  
IECEx BVS 16.0030X

### Kennzeichnung:

 II 1G  
Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

### Thermische Kenngrößen:

| Temperaturklasse | Umgebungstemperaturbereich $T_a$ | Maximal zulässige Prozesstemperatur |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| T6               | -20 °C < $T_a$ < +70 °C          | 70 °C                               |
| T4               | -20 °C < $T_a$ < +120 °C         | 120 °C                              |
| T3               | -20 °C < $T_a$ < +135 °C         | 135 °C                              |

### Besondere Bedingung

- Kabel und Sensor dürfen nur in dem für die Temperaturklasse angegebenen Umgebungstemperaturbereich betrieben werden.
- Das Messkabel muss einschließlich seines Anschlusskopfes vor elektrostatischer Aufladung geschützt werden, falls es durch Bereiche der Zone 0 (Kategorie 1G) geführt wird.
- Die Memosens-Sensoren dürfen nicht unter elektrostatisch kritischen Prozessbedingungen betrieben werden. Unmittelbar auf das Verbindungssystem einwirkende starke Dampf- oder Staubströme müssen vermieden werden.
- Metallische Prozessanschlusssteile müssen am Einbauort elektrostatisch leitfähig (< 1 M $\Omega$ ) angebunden werden.

# Instructions for Use for the Series SE554 pH/ORP Sensors



**WARNING – Failure to observe this warning may result in serious injury.**

The warning symbol on the rating plate means:

**Read these instructions for use, observe the Specifications, and follow the Safety Instructions.**

## 1 Safety Instructions

### 1.1 All Applications – All Sensor Variants

Hazards due to pressure, temperature, aggressive media or explosive atmosphere are possible, depending on the location of use. Therefore, the installation, operation, and servicing of the sensor shall only be carried out by suitably trained personnel authorized by the operating company.

### 1.2 Hazardous Areas – All Sensor Variants

Observe all applicable local codes and standards for the installation of electrical equipment in hazardous locations. For orientation, please refer to IEC 60079-14, EU directives 2014/34/EU and 1999/92/EC (ATEX), NFPA 70 (NEC), ANSI/ISA-RP12.06.01. The electrical and thermal parameters of the sensors must be adhered to.

### 1.3 Hazardous Areas – Sensors with Memosens Connector

Memosens Ex sensors are marked by an orange-red ring. Combined with a model CA/MS-\*\*\*X\*\* or model CA/MS-\*\*\*X\*\*L measuring cable or a certified measuring cable which is identical in hardware and function, the sensor may be connected to a suitable measuring device, as described in the Certificates BVS 15 ATEX E141 X and IECEx BVS 15.0114X.

### 1.4 Hazardous Areas – Sensors with VP Connector

The sensors shall only be operated with an approved device in floating, intrinsically safe circuits.

## 2 Intended Use

The sensor is used for continuous measurement of pH and optionally of ORP (Model AMSN) in liquid media. The SE 554 is a low-maintenance (polymer electrolyte) and pressure-resistant sensor. It has a temperature detector for automatic temperature compensation. The sensor is designed for applications in industrial processes:

- Heavily polluted media
- Media containing sulfides
- Emulsions and suspensions
- Alkaline media
- Media containing proteins
- Processes with large pressure variations
- Acidic media
- Media containing solvents

The sensor is non-sterilizable / non-autoclavable and unsuitable for measurements in media containing chlorine or bromine.

## 3 Installation and Commissioning

- On unpacking, check the sensor for mechanical damage. Report any damage to your Knick service team.
- Remove the watering cap and briefly rinse the sensor with pure water. After rinsing, the sensor should only be dabbed dry with a tissue. Do not rub the pH-sensitive glass, since this can lead to electrostatic charging and sluggish response times.
- Check the space behind the pH-sensitive glass for the presence of any air bubbles and remove them by gently swinging the sensor in a vertical plane.
- Install the sensor in the fitting as described in the user manual of the respective fitting.
- Connect sensor and cable.

## 4 Operation

### 4.1 Calibrating the Sensor

2-point pH calibration is recommended for the SE554 sensor: First remove the watering cap. Then dip the sensor successively into two different buffer solutions with given pH values (e.g., CaliMat pH 7.00 and pH 4.00) and calibrate the sensor to these buffer values. ORP calibration is performed as a 1-point calibration (delta value) using an ORP calibration solution. Please refer to the user manual of the pH transmitter for further details.

### 4.2 Temperature Detector

The integrated temperature detector is intended for automatic compensation of the pH signal and not for any high-precision and safe temperature indication or control of the process temperature.

## 5 Maintenance and Cleaning

Carefully rinse the sensor tip and junction with pure water after each operating cycle. Under no circumstances must measuring solution be allowed to dry on these parts!

When the sensor is not in operation, store it with sensor tip and junction well submerged in electrolyte (3 mol/l KCl). If a sensor is stored dry for a few days by mistake, let it soak in electrolyte for several hours before use.

## 6 Specifications

### Model Code

The markings on each sensor or on the packaging label include the following information:

SE554X/1-AMSN

### Model designation

Sensor connector

MS: Memosens®

VP: VarioPin

Pt electrode (ORP)

A: with

N: without

Length

1: 120 mm

2: 225 mm

Ex approval

X: Yes

### Further Data

|                     |  |
|---------------------|--|
| pH/ORP range        | 0 ... 14 / ±1500 mV  |
| Temperature         | 0 ... 130 °C   |
| Pressure, relative  | 0 ... 10 bar   |
| Junction            | 2 x hole   |
| Electrolyte         | Solid polymer  |
| Reference system    | Ag/AgCl  |
| pH sensor material  | Alpha glass<br>medium impedance,<br>universal glass,<br>fluoride resistant |
| ORP sensor material | Platinum   |
| Body material       | Glass  |
| Mounting            | PG 13.5  |
| Temp detector       | MS connector: NTC 30 kΩ<br>VP connector: Pt1000                            |


## 7 Disposal

Observe the applicable local or national regulations for disposal.

**Knick** ➤

Manual

SE554X/\*-AMSN  
SE554X/\*-NMSN  
SE554X/\*-NVPN

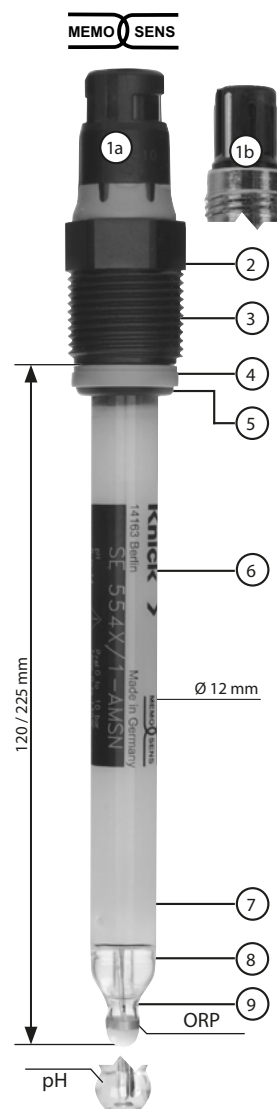

- ① Sensor connectors  
a - MS  
b - VP
- ② 19 mm A/F, serial number
- ③ PG 13.5 thread
- ④ PVDF compression ring
- ⑤ EPDM-FDA O-ring (11.5 x 2.6 mm)
- ⑥ Rating plate
- ⑦ Junction
- ⑧ pH glass
- ⑨ Platinum (ORP sensors only)

**Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG**

Beuckestraße 22

14163 Berlin

Germany

Phone: +49 30 80191-0

Fax: +49 30 80191-200

Email: info@knick.de

Internet: www.knick-international.com



100584

TA-SE554X-KNXX03


20220809

# Hazardous Areas: Electrical and Thermal Parameters

## For Sensors with VP Connector

**Certificate Number:**

PTB 14 ATEX 2004

**Marking:** II 1/2 G Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb**Electrical Parameters:**

- From a safety perspective, all circuits including the cable shield shall be considered as galvanically connected to ground.
- Metallic process connection parts shall be included in the local equipotential bonding system.
- The effective internal inductance  $L_i$  and capacitance  $C_i$  are negligibly small.

| Temperature class | Maximum input voltage $U_i$ | Maximum input current $I_i$ | Maximum input power $P_i$ |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| T6                | 12 V                        | 30 mA                       | 50 mW                     |
| T4                | 15 V                        | 80 mA                       | 110 mW                    |
| T3                | 18 V                        | 170 mA                      | 200 mW                    |

**Thermal Parameters:**

The integrity of the equipment is not impaired when the standardized atmospheric conditions are exceeded within the limits of the manufacturer's specifications, e.g., with regard to ambient temperature and pressure.

The maximum heating to be considered with regard to the temperature class is consistently based on the available power of the externally connected circuits and is 427 K/W in air. The maximum permissible ambient temperature is 40 °C.

| Temperature class | Maximum input power $P_i$ | Maximum permissible process temperature |
|-------------------|---------------------------|---|
| T6                | 50 mW                     | 55 °C                                   |
| T4                | 110 mW                    | 80 °C                                   |
| T3                | 200 mW<br>110 mW          | 100 °C<br>135 °C                        |

**Special Conditions**

None

## For Sensors with Memosens Connector

**Certificate Number:**BVS 16 ATEX E 037 X  
IECEX BVS 16.0030X**Marking:** II 1G  
Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga**Thermal Parameters:**

| Temperature class | Ambient temperature range $T_a$ | Maximum permissible process temperature |
|-------------------|---------------------------------|---|
| T6                | -20 °C < $T_a$ < +70 °C         | 70 °C                                   |
| T4                | -20 °C < $T_a$ < +120 °C        | 120 °C                                  |
| T3                | -20 °C < $T_a$ < +135 °C        | 135 °C                                  |

**Special Conditions**

- The cable and the sensor shall only be used within the ambient temperature range specified for the temperature class.
- The measuring cable including its connecting head must be protected from electrostatic charging if it passes through areas of Zone 0 (category 1G).
- The Memosens sensors shall not be operated in electrostatically critical processing conditions. Intense vapor or dust flows directly impacting on the connection system shall be avoided.
- Metallic process connection parts must be mounted at the installation site so that they are electrostatically conductive (< 1 MΩ).